

Sistema BD Veritor™ SARS-CoV-2

Para detección rápida de SARS-CoV-2



Simple

Sencillo de usar



Confiable

Utiliza un lector que elimina la subjetividad de la lectura.



Trazabilidad

Módulo infoscán permite el registro de los resultados.



- ✓ Inmunocromatografía digital.
- ✓ Detección de proteína N del SARS CoV-2.
- ✓ Muestra nasal, mayor comodidad para el paciente.
- ✓ Resultados en 15 min.
- ✓ Autorización EUA de FDA.
- ✓ Sensibilidad 84%, Especificidad 100%.



BD Veritor™ SARS-CoV-2

El Sistema Veritor™ Plus es un dispositivo Point of Care lo que permite que el resultado se obtenga al lado del paciente. El dispositivo BD Veritor™ Plus Analyzer disminuye los errores de lectura debidos al usuario y se obtienen resultados objetivos.


El equipo tiene una capacidad de 3500 lecturas y cuenta con controles de calidad positivos y negativos. El equipo BD Veritor™ Plus cuenta con formato “Solo lectura”, que permite manejar un flujo grande de muestras y solo se demora 5s en la lectura del resultado.




LECTOR DIGITAL COMPACTO
CON BATERÍA RECARGABLE

BD Veritor™ SARS-CoV-2 viene a completar la familia de pruebas que se pueden realizar en este dispositivo como FLU A & B, RSV y Estreptococo grupo A.

BD Veritor™ SARS-CoV-2 detecta la proteína N del SARS CoV-2 en hisopados nasales. Esta técnica tiene la aprobación EUA dada por la FDA y tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 100%. Sus resultados se obtienen solo en **15 minutos**.

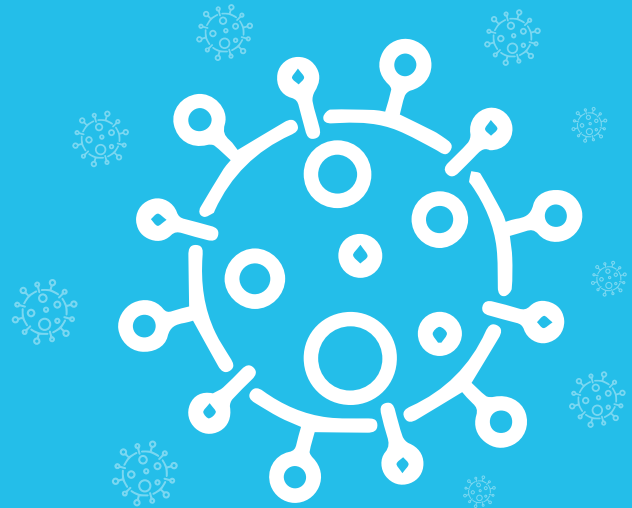


BD Veritor™ Plus cuenta con módulo INFOSCAN que permite guardar la información de los resultados obtenidos ayudando a la trazabilidad de estos. Además el equipo permite conectarse a una impresora para imprimir los resultados o transferir los resultados a un computador por medio de un puerto USB.

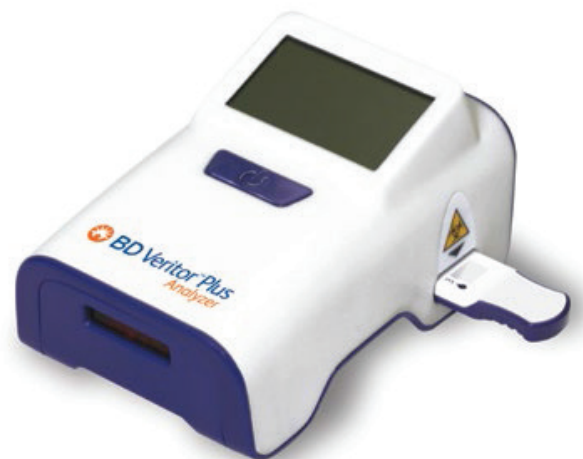

Simplificando el diagnóstico de COVID-19

El sistema portátil y fácil de usar BD Veritor PLUS proporciona resultados confiables para la detección de COVID-19 (SARS CoV-2) en solo **15 minutos**.

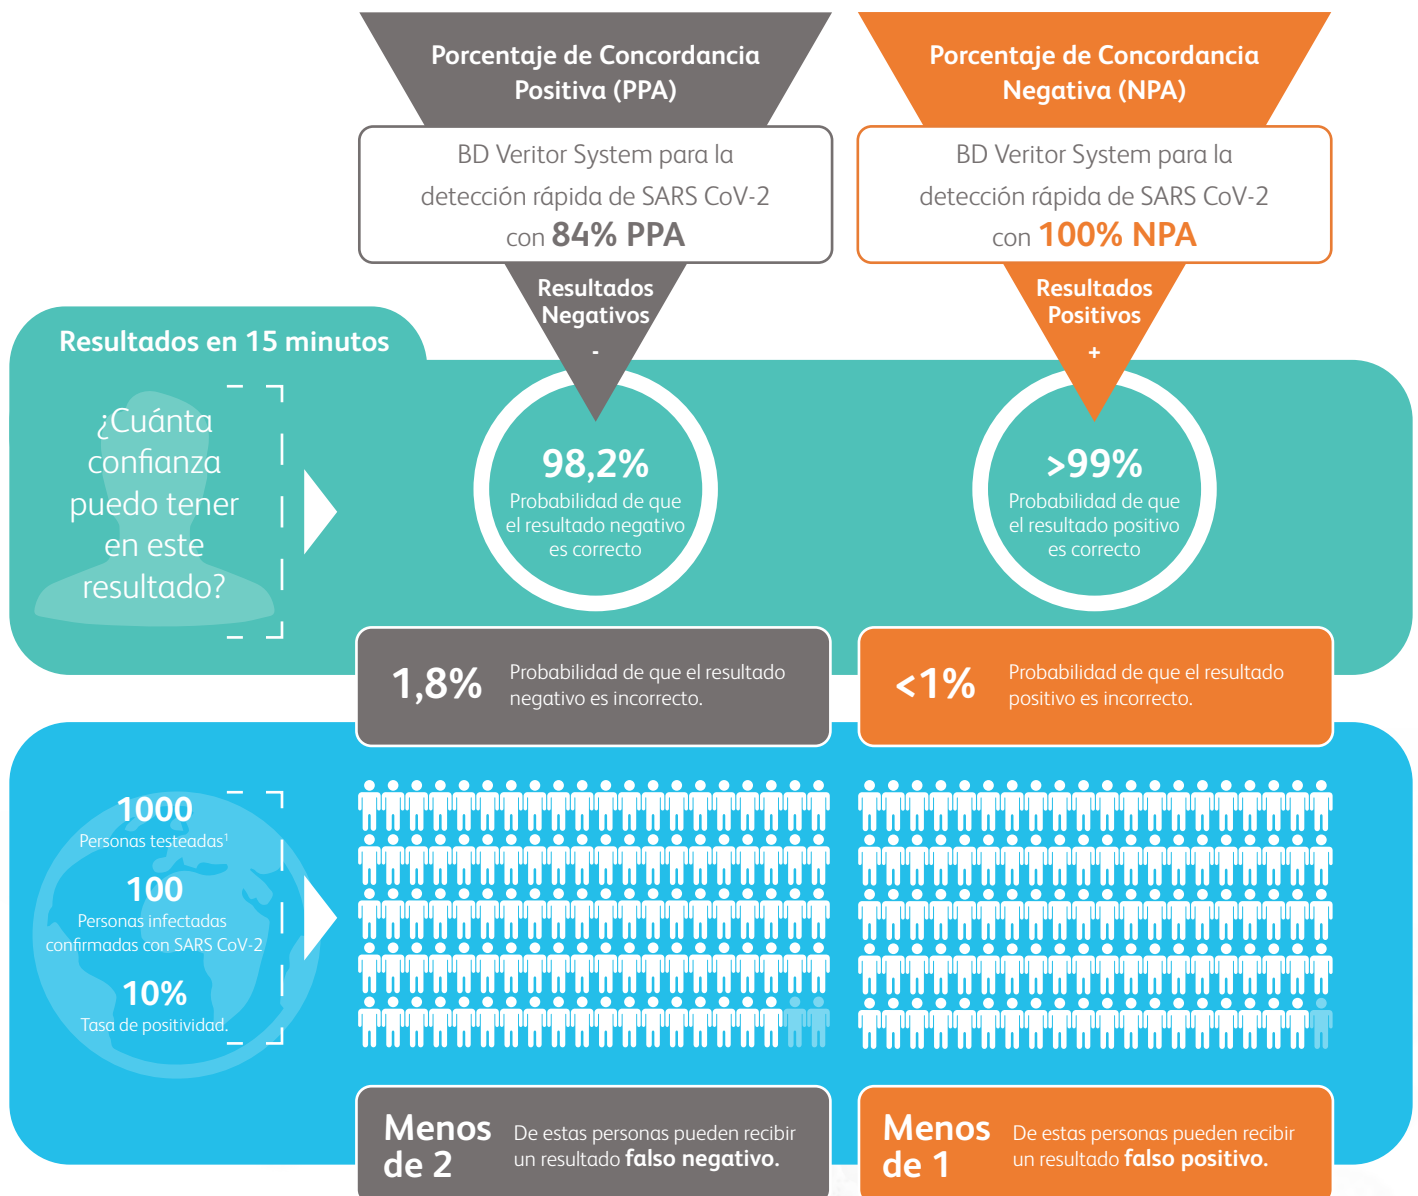

¹ El uso previsto de BD Veritor System para la detección rápida de SARS CoV-2 solo incluye a aquellas personas con sospecha de COVID-19, dentro de los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas.

BD Argentina

Av. del Libertador 110 - 2° Piso

Tel: 0800-444-55BD (23)

Vicente López, Buenos Aires, Argentina.

BD Chile

Av. Andrés Bello 2325 - piso 15

Tel: (+56 2) 2482 7800

Providencia, Santiago, Chile.

*Consultar disponibilidad en la región

En Argentina:

**Venta exclusiva a Laboratorios de análisis clínicos. USO PROFESIONAL EXCLUSIVO.

Se encuentran registrados ante ANMAT: el instrumento BD Veritor™ Plus Analyzer, BD Veritor™ InfoScan Module y reactivos BD Veritor™ Flu A+B bajo el PM-634-584, y los reactivos de BD Veritor™ RSV bajo el PM-634-585.

bd.com

BD, BD Logo y todas las marcas son propiedad de Becton Dickinson and Company © 2020.

